

Erfassungsbogen ProWalker®

Angebot Bestellung Probeversorgung wachstumsbedingte Anpassung Reparatur

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker für

Kom.

zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

- Die Körpergröße sollte 80 cm nicht unterschreiten und darf 150 cm (bei Erstversorgung minus 10 cm, d.h. 140 cm) nicht überschreiten
- max. Körpergewicht 45 kg (bei Erstversorgung ca. 35 kg)
- Maßblatt und Bestellbogen vollständig ausfüllen
- Maßnehmen in Rückenlage
- Maßnehmen in normaler Tageskleidung, Schuhen und gegebenenfalls Orthesen
- Um das Maß „B“ zu ermitteln, messen Sie vom Kniedrehpunkt bis zur Auftrittsfläche der Schuhsohle. Liegt ein funktioneller oder kontrakter Spitzfuß vor, ist dies entsprechend zu berücksichtigen (Längenausgleich)



Nach Abschluss des vollständigen Maßnehmens, können wir Ihnen eine bestmögliche Versorgung mit dem ProWalker gewährleisten.

Versorgerdaten	Firma:	
	zuständiger Mitarbeiter:	
	Telefon bei Rückfragen:	rezept. Arzt:
	Datum / Maß genommen am:	



Notizen:

Massblatt ProWalker®


Patientendaten	Name:	Seriennummer bei vorh. Gerät:
	Straße:	PLZ/Ort:
	Telefon:	Geburtsdatum:
	Diagnose:	Körpergewicht:

Bitte alle Maße in cm angeben!

- = Länge/Breite (cm)
- = Tiefe (cm)
- = Umfang (cm)

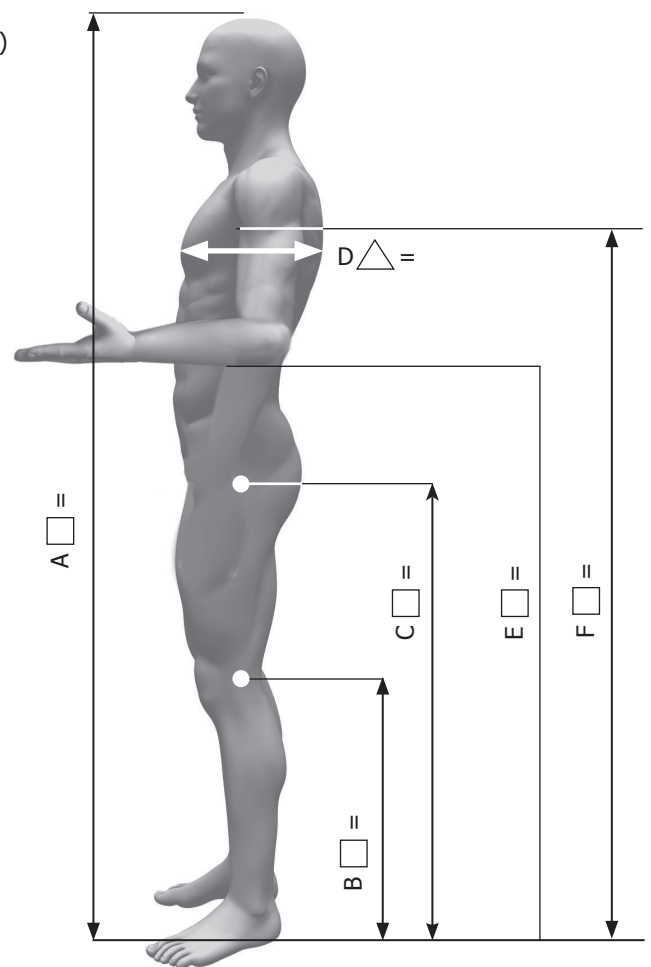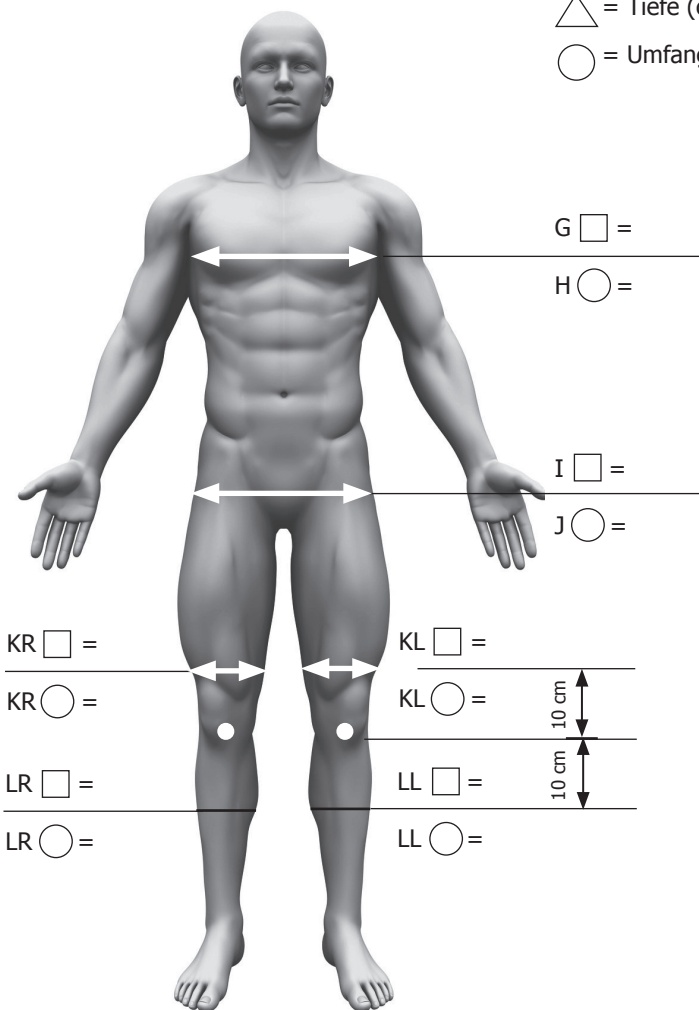

Schuhmaße:

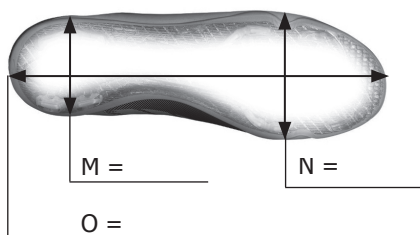

Handmanschette:



Größe:

- S = 5 cm bis 8,5 cm
- M = 8,5 cm bis 10 cm
- L = 10 cm bis 12 cm
- XL = 12 cm bis 14 cm