Bestellbogen

Dynamic GPS Soft-Orthese

Bitte per E-Mail an bestellungen@prowalk.de ☐ Angebot ☐ Bestellung

Sanitätshaus/Ansprechpartner: Interne Kontroll-Nr.:

Adresse: Bestell-Nr.:

Name des Patienten:

Körpergröße: Alter: Gewicht: ☐ männlich ☐ weiblich

abweichende Lieferadresse:

☐ Folgeversorgung ☐ Erstversorgung

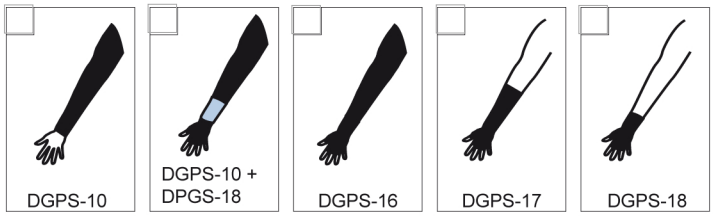

Farbmuster siehe Farbkarte!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
2) Grundsätzlich gilt: Die Maße sind locker und ohne Spannung zu nehmen.
3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. Wird dies nicht berücksichtigt, kann es zu Einschnürungen an den Orthesenenden kommen.
4) Die Lyrcalagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Besonderheiten/Bemerkungen:

© Pro Walk PM-PW-Dyn.GPS BB10,10/20

PRO WALK

Name des Patienten: Bestell-Nr.:

RECHTS

○ Umfangsmaße
□ Längenmaße
○ Umfangsmaße/ Abschlussmaße, Maßzugabe berücksichtigen

Achtung:
16 = anatomisches Maß
(+4 mm)

„Fingerlänge"= Orthesenlänge

Daumen	□ 3 =	_____
Zeigefinger	□ 6 =	_____
Mittelfinger	□ 9 =	_____
Ringfinger	□ 12 =	_____
Kleiner Finger	□ 15 =	_____

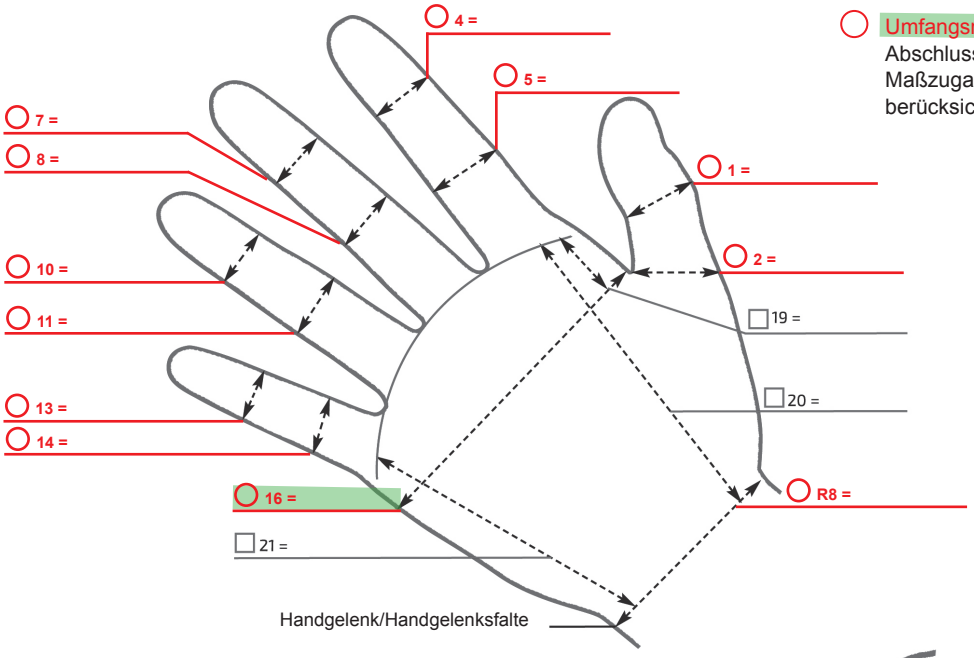

Achtung:
R6 = Ellenbogengelenk über prominenteste Stelle gemessen (+4 mm).
R4 = Abschluss der Orthese
R9 = Länge des Oberarmes, Toleranz zur Achsel berücksichtigen

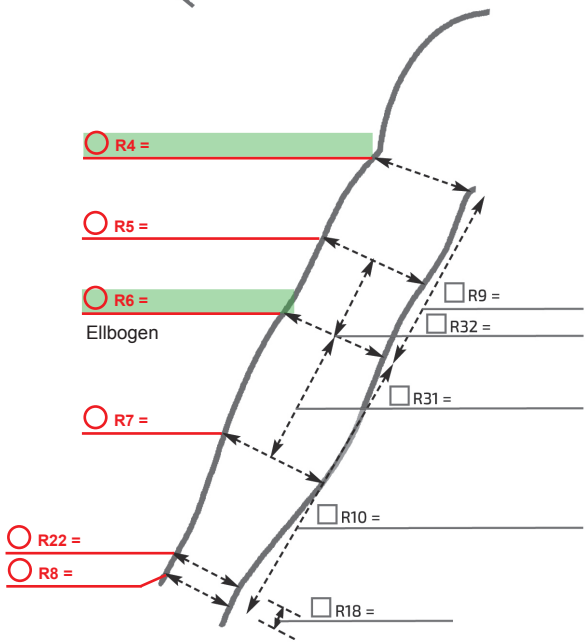

bei Beugekontraktur erheben

Neutral-Null Flex/Ex: _____

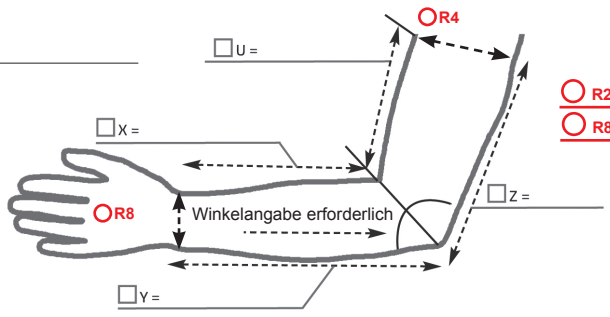

PRO WALK

Name des Patienten: Bestell-Nr.:

LINKS

○ Umfangsmaße
□ Längenmaße
○ Umfangsmaße/ Abschlußmaße, Maßzugabe berücksichtigen

Achtung:
16 = anatomisches Maß
(+4 mm)

„Fingerlänge"= Orthesenlänge

Daumen	□ 3 =	_____
Zeigefinger	□ 6 =	_____
Mittelfinger	□ 9 =	_____
Ringfinger	□ 12 =	_____
Kleiner Finger	□ 15 =	_____

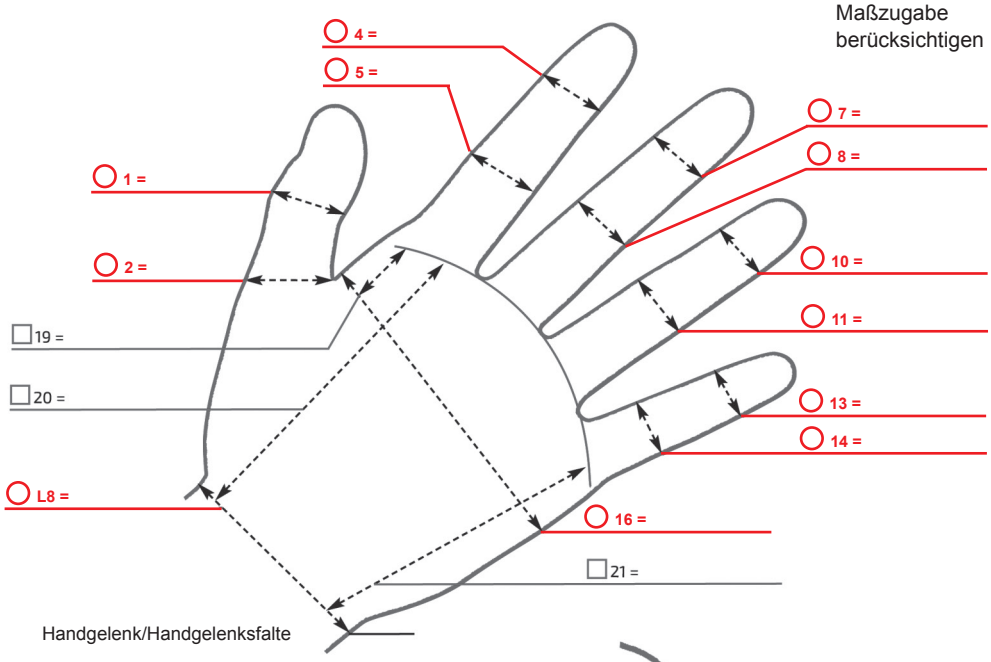

Achtung:
R6 = Ellenbogengelenk über prominenteste Stelle gemessen (+4 mm).
R4 = Abschluss der Orthese
R9 = Länge des Oberarmes, Toleranz zur Achsel berücksichtigen

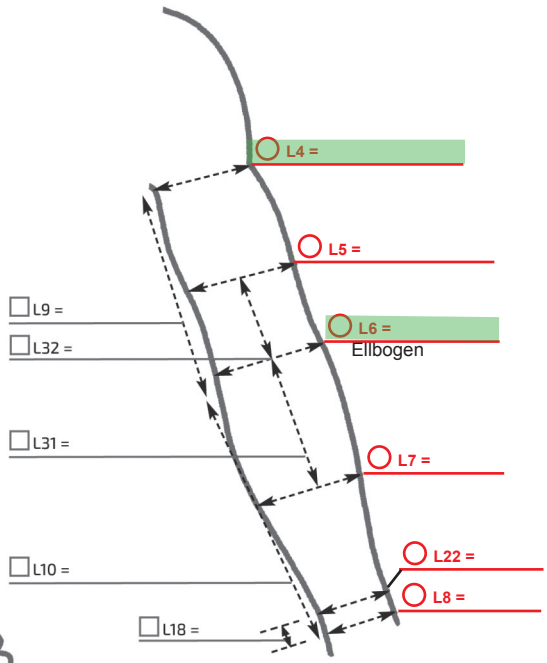

bei Beugekontraktur erheben

Neutral-Null Flex/Ex: _____

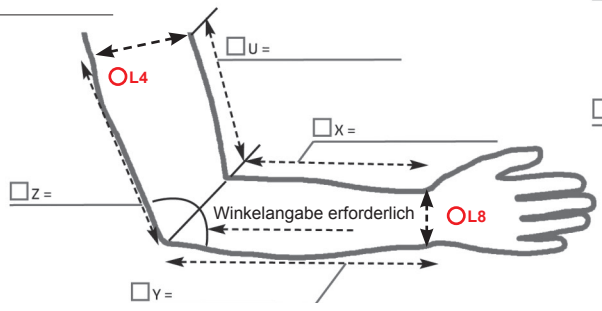

Ankreuzliste

Wenn von Ihnen nicht anders angegeben, wird die von Ihnen bestellte Dynamische GPS Soft-Orthese mit den hier markierten Standardoptionen geliefert. Wenn Sie diese nicht wünschen, streichen Sie diese deutlich aus und ergänzen den Bogen entsprechend.

Bitte berücksichtigen Sie, dass maximal sechs (6) Lycralagen übereinander vernäht werden können, d.h. maximal drei (3) Lycralagen vorne und drei (3) Lycralagen auf der Rückseite der Orthese. Sofern Sie eine ausgewählte Lycralage nicht näher definieren, wird diese als einlagige Option in Ihrer Versorgung berücksichtigt.

☐ Standardspezifikationen ☐ Standardspezifikationen wie vorgeschlagen plus Zusatzoptionen ☐ geänderte Standardspezifikationen plus Zusatzoptionen

Beschreibung:	RECHTS	Anzahl der Lagen	Option gewünscht	LINKS	Anzahl der Lagen	Option gewünscht
Verstärkungspelotte zur Unterstützung der Dorsalextension	DGPS-DEX.1	1	☑	DGPS-DEX.2	1	☑
Verstärkungspelotte zur Unterstützung der Supination	DGPS-SUP.1	1	☑	DGPS-SUP.2	1	☑
Reißverschluss über 2/3 des Unterarms	DGPS-ZDH.1	1	☑	DGPS-ZDH.2	1	☑

ARR

Radiale Seitenverstärkung von der Daumenbasis nach proximal
zur Unterstützung der Radialduktion, um der Ulnardeviation entgegenzuwirken

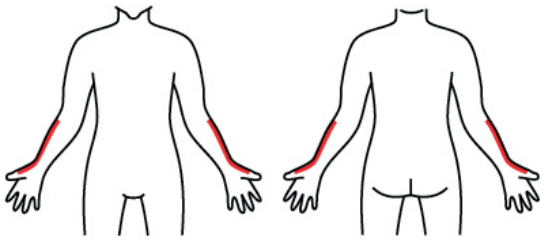

Vorderansicht Rückansicht

DGPS-ARR.1 rechts ____ ☐
DGPS-ARR.2 links ____ ☐

AUR

Ulnare Seitenverstärkung
zur Unterstützung der Ulnarduktion, um der Radialdeviation entgegenzuwirken

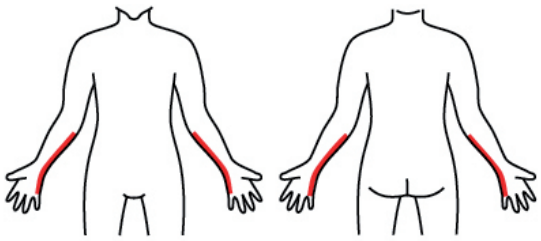

Vorderansicht Rückansicht

DGPS-AUR.1 rechts ____ ☐
DGPS-AUR.2 links ____ ☐

ATA

Verstärkungspelotte für die Daumenabduktion
um einer ausgeprägten Daumenadduktion entgegenzuwirken

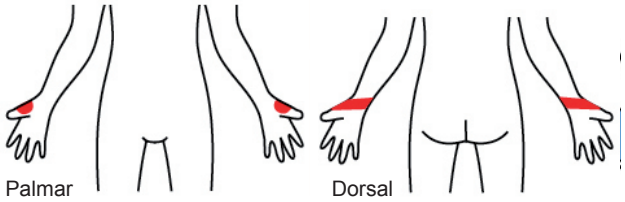

Palmar Dorsal

DGPS-ATA.1 rechts ____ ☐
DGPS-ATA.2 links ____ ☐

AIR

Verstärkungspelotte für die Pronation des Unterarms
um der Außenrotation der Schulter/des Arms entgegenzuwirken

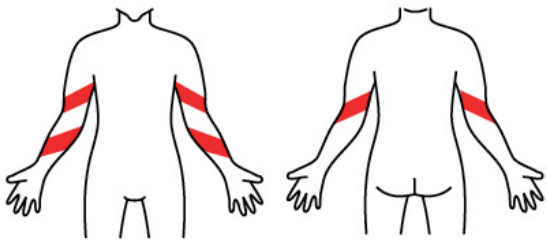

Vorderansicht Rückansicht

DGPS-AIR.1 rechts ____ ☐
DGPS-AIR.2 links ____ ☐

AED

Verstärkungspelotte für die Supination des Unterarms
um der Innenrotation der Schulter/des Arms entgegenzuwirken

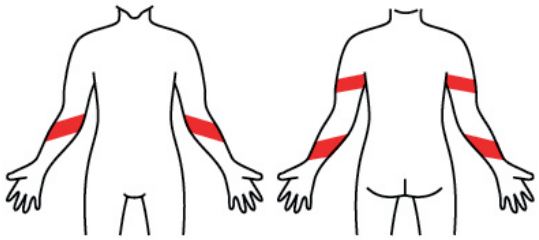

Vorderansicht Rückansicht

DGPS-AED.1 rechts ____ ☐
DGPS-AED.2 links ____ ☐

AHX



Ellenbeuge

Verstärkungszüge, die gegen die Überstreckung des Ellbogens wirken (rechts/links, bitte Seite angeben!)

DGPS-AHX.1 rechts 1 ☐
DGPS-AHX.2 links 1 ☐

ADT



Ellbogenspitze

Verstärkungszug, der die Extension im Ellbogen unterstützt

DGPS-ADT.1 rechts ____ ☐
DGPS-ADT.2 links ____ ☐

AEX

Bemaßen der Hand in Dorsalextension
um gegen eine Flexion zu arbeiten



☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°

DGPS-AEX.1 rechts 1 ☐
DGPS-AEX.2 links 1 ☐

AFX

Bemaßen der Hand in Volarflexion
um gegen eine Dorsalextension zu arbeiten.

☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°

DGPS-AFX.1 rechts 1 ☐
DGPS-AFX.2 links 1 ☐

AEA

Ellenbogengelenk Winkelangabe in Grad nach der Neutral-Null-Methode

Winkelangabe: _____

DGPS-AEA 1 ☐

ARD

Die Orthese wird in 10° Radialduktion gefertigt, um einer bestehenden Ulnarduktion entgegenzuwirken.

DGPS-ARD.1 rechts 1 ☐
DGPS-ARD.2 links 1 ☐

Optionen, die einer Ataxie und einem Tremor entgegenwirken:

ATP
Spezielle Verstärkungspelotte, um einem proximalen Tremor im Unterarm entgegenzuwirken.

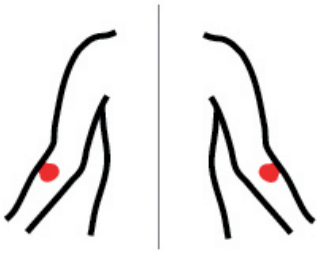

DGPS-ATP.1 rechts ____ ☐
DGPS-ATP.2 links ____ ☐

ATD
Spezielle Verstärkungspelotte, um einem distalen Tremor im Unterarm entgegenzuwirken.

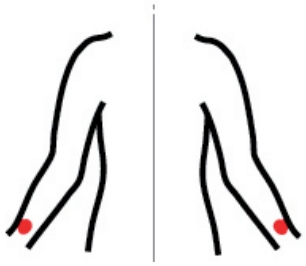

DGPS-ATD.1 rechts ____ ☐
DGPS-ATD.2 links ____ ☐

ATX **Spezielle Verstärkungspelotte**, um einem globalen Tremor im Unterarm entgegenzuwirken.

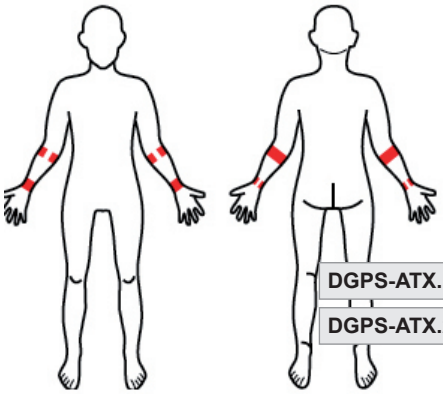

Vorderansicht Rückansicht

DGPS-ATX.1 rechts ____ ☐
DGPS-ATX.2 links ____ ☐

Zusatzoptionen

– ohne Abbildung –

Lycrazüge unter Vorspannung	**DGPS-PSP** ☐	

genaue Angabe welcher Zug/Züge: _____

Reißverschlüsse

– ohne Abbildung –

Reißverschluss bis zum oberen Ende bei kurzem Arm	**DGPS-A1.1 rechts** ☐	**DGPS-A1.2 links** ☐
Reißverschluss bis zum oberen Ende bei langem Arm	**DGPS-A2.1 rechts** ☐	**DGPS-A2.2 links** ☐

Wähle aus jeder Rubrik eine Option 1–2–3 und fertig ist Deine individuelle Orthese!

PRO WALK

1 Baumwollträgermaterial

- Hautfarben ☐
- Lila ☐
- Dunkelblau ☐
- Schwarz ☐
- Weiß ☐
- Rot ☐
- Racing Green ☐
- Dunkel Lila ☐
- Hell Rosa ☐
- Sky ☐
- Sweetheart* ☐
- Iceage* ☐

*(nur ventral am Rumpf anwendbar und **zusätzlich** zur Grundfarbe)

Trägermaterial-Nr:

2 Lycra-Pelotten/ Verstärkungszüge

- Hautfarben ☐
- Lila ☐
- Dunkelblau ☐
- Schwarz ☐
- Weiß ☐
- Knall Pink ☐
- Rot ☐
- Hell Rosa ☐
- Sky ☐

Lycra-Lager-Nr:

3 Nahtfarben

- Hautfarben ☐
- Grün ☐
- Lila ☐
- Orange ☐
- Dunkelblau ☐
- Gelb ☐
- Schwarz ☐
- Cerise ☐
- Weiß ☐
- Racing Green ☐
- Knall Pink ☐
- Dunkel Lila ☐
- Rot ☐
- Sky ☐
- Hell Rosa ☐

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Nahtfarben-Nr:

Datum: Ansprechpartner:

Bestellung erfolgt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Stempel/Unterschrift:

Per E-Mail senden >>