Bestellbogen
Dynamic GPS Soft-Orthese

Bitte den Bestellbogen zuerst downloaden und dann vollständig ausfüllen!

Bitte als PDF per E-Mail an bestellungen@prowalk.de

Sanitätshaus/geschulter Partner:

Adresse:

abweichende Lieferadresse:

Name des Patienten:

Körpergröße: Alter: Gewicht: ☐ männlich ☐ weiblich

☐ Folgeversorgung ☐ Erstversorgung

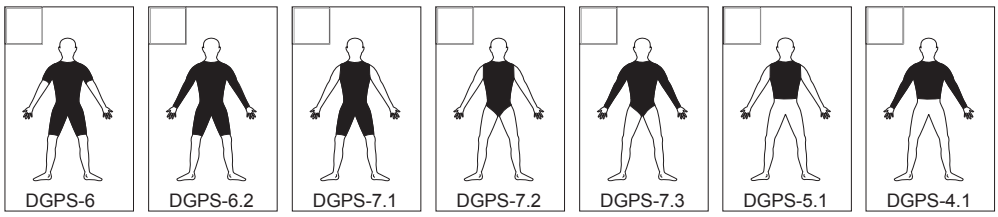

Farbmuster siehe Farbkarte!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1) Die Richtlinien des Maßnehmens und der Versorgungsoptionen sind dem jeweils aktuellen Handbuch zu entnehmen. Dieses ist Bestandteil der Zertifizierungs- und Refresherseminare.
2) Grundsätzlich sind Hautmaße zu nehmen.
3) An den jeweiligen Abschlussmaßen sind 5% Maßzugabe hinzuzugeben, da die Orthesen volumenreduziert gefertigt werden, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
4) Die Lyrcalagen sind sorgfältig und nachvollziehbar mit dem Versorgungsziel abzugleichen.
5) Um Verzögerungen und Rückfragen im Bestellprozess zu vermeiden, sollte die Bestellung auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft werden.

Besonderheiten/Bemerkungen:

© Pro Walk PM-PW-Dyn.GPS BB10, 05/24

☐ Längenmaße
○ Umfangsmaß
mögliche Abschlussmaße je nach Modell + 5% Maßzugabe

WICHTIGE HINWEISE:
Achtung: Besonderheiten zu Umfangs-/Abschlussmaßen siehe Handbuch!
Maße R/L2 + R/L3**** lockeres Hautmaß
Maße R/L9*: bei kurzem Ärmel bis Ärmelende R/L5 messen

PRO WALK

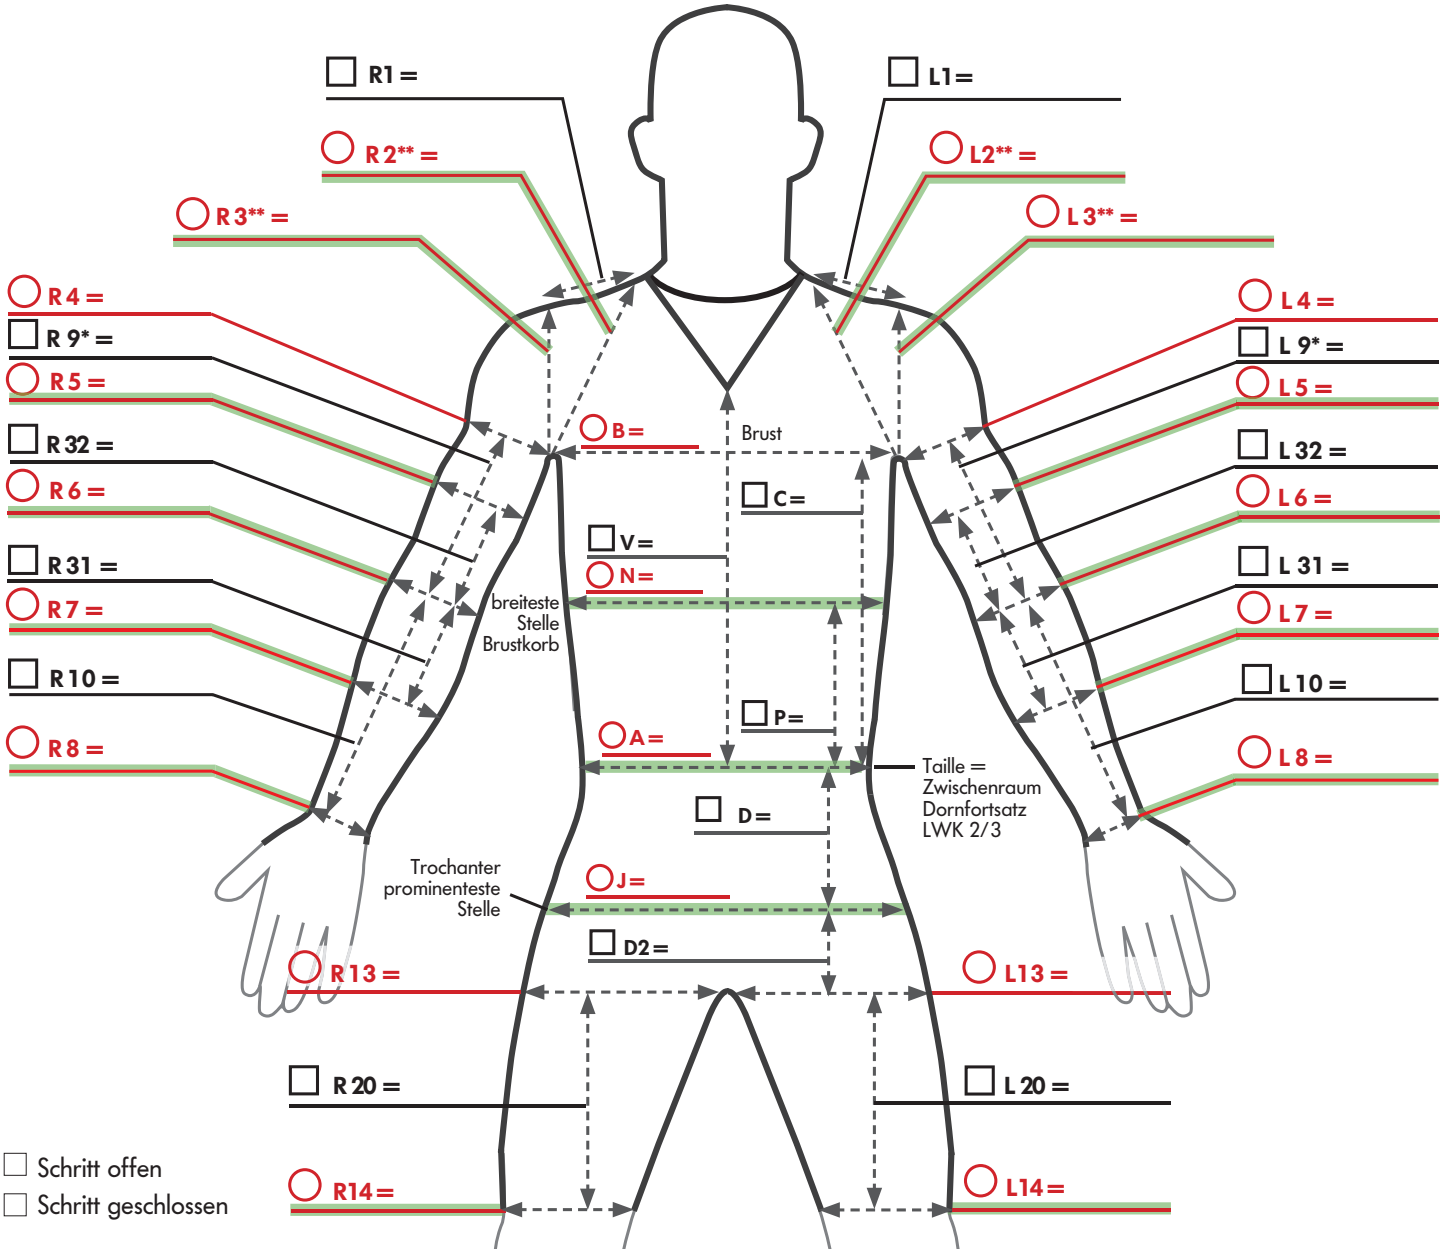

☐ Schritt offen
☐ Schritt geschlossen

☐ V-Ausschnitt:
Maß V= _____
(Unterkante V-Ausschnitt bis zum Taillenmaß A)

zusätzlich:
Maß K= _____
Länge von Höhe Maß A ventral, zu Höhe Maß A dorsal durch den Schritt gemessen (nur bei geschlossenem Schritt nötig)

Bei Auswahl von BH-Körbchen TBS oder TABS

Brustumfang unter der Brust	
Brustumfang über der Brust (auf Höhe der Brustwarze)	
Taille – Brustansatz	
Körbchengröße	

Scheitelpunkt der Skoliose
Verlauf skizzieren (Taille – Scheitelpunkt messen)

rechts	links
☐ = _____	☐ = _____

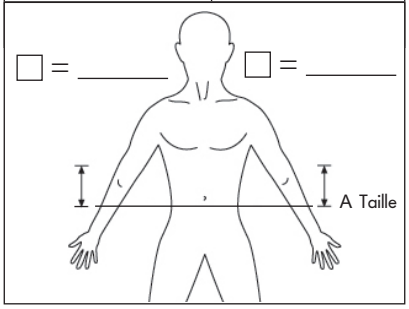

Ankreuzliste

Standardspezifikationen

DGPS 6 / 6.2 / 7.1:

Optionen gewünscht:

- ☐ Lycralage über den gesamten Rücken und seitlich am Rumpf, bis hinunter zum Gesäß
- ☐ Lycralage über das Becken
- ☐ Reißverschluss ventral und dorsal am Rumpf

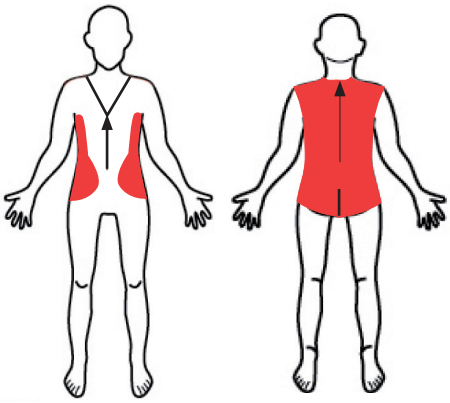

Vorderansicht Rückansicht

DGPS 7.2 / 7.3:

Optionen gewünscht:

- ☐ Lycralage über den Rücken und seitlich am Rumpf
- ☐ Lycralage über das Becken
- ☐ Reißverschluss ventral und dorsal am Rumpf
- ☐ Druckknöpfe am Zwickel

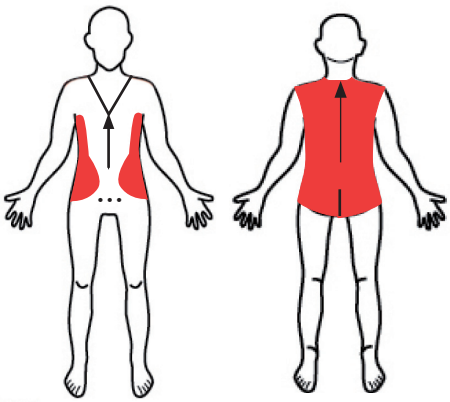

Vorderansicht Rückansicht

DGPS 4.1 / 5.1:

Optionen gewünscht:

- ☐ Lycralage über den Rücken und seitlich am Rumpf
- ☐ durchgehender Reißverschluss ventral am Rumpf
- ☐ Silikonstreifen am unteren Abschluss

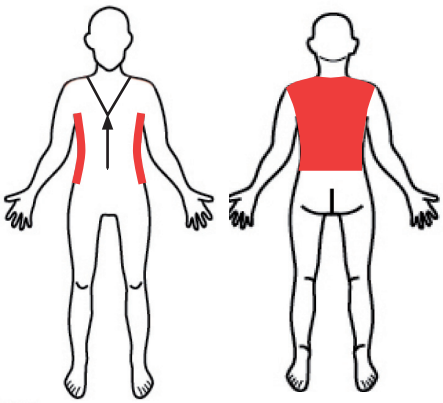

Vorderansicht Rückansicht

Lycralage zur Unterstützung der Außenrotation der Beine



☐ rechts
☐ links

Anzahl

DGPS-LER rechts _____ ☐
DGPS-LER links _____ ☐

Lycralage zur Unterstützung der Innenrotation der Beine

☐ rechts
☐ links

Anzahl

DGPS-LIR rechts _____ ☐
DGPS-LIR links _____ ☐

PRO WALK

individuelle Zusatzoptionen

TOS

Lycralage für die Verbesserung der Schulterretraktion.

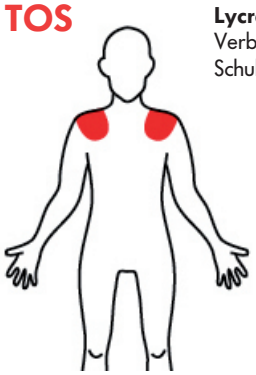

Vorderansicht

Anzahl

DGPS-TOS rechts	_____	☐
DGPS-TOS links	_____	☐

TCO

Lycralage für die Verbesserung der thorakalen Aufrichtung.

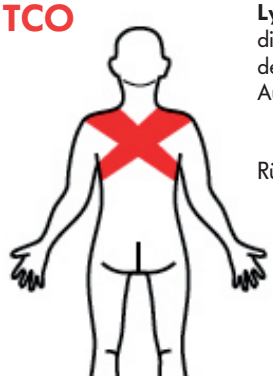

Rückansicht

Anzahl

DGPS-TCO	_____	☐
Vorspannung		☐

TOSD

Lycralage für die Verbesserung der Schulterretraktion und -depression (Erweiterung des TOS).

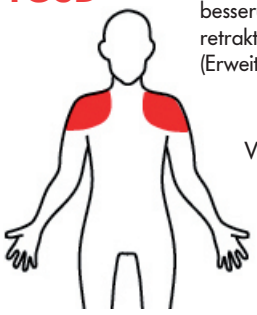

Vorderansicht

Anzahl

DGPS-TOSD rechts	_____	☐
DGPS-TOSD links	_____	☐

TCOD

Lycralage zur Verbesserung der thorakalen Aufrichtung und der Schulterretraktion (Erweiterung des TCO).

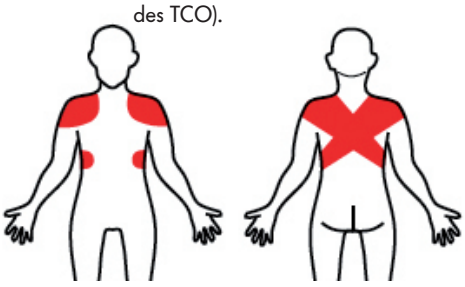

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-TCOD	_____	☐

TCC

Lycralage zur Verbesserung der Schulterdepression und -retraktion bei elevierten Schultern.

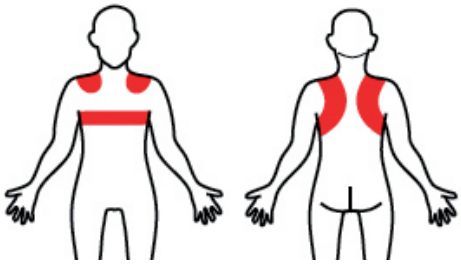

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-TCC	_____	☐

TSL (Abb. für rechts)

Lycralage zur Unterstützung bei Subluxation der Schulter.

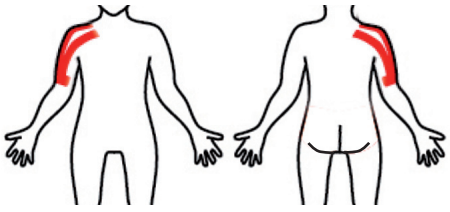

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-TSL rechts	_____	☐
DGPS-TSL links	_____	☐

AED

Lycralage zur Verbesserung der Außenrotation des Oberarms und der Supination des Unterarms.

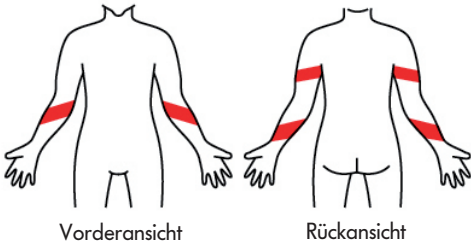

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-AED rechts	_____	☐
DGPS-AED links	_____	☐

AIR

Lycralage zur Verbesserung der Innenrotation des Oberarms und der Pronation des Unterarms.

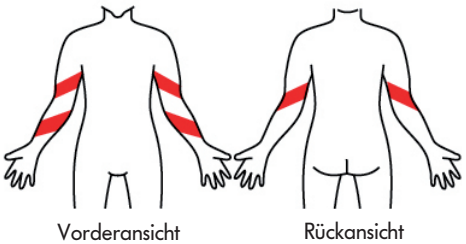

Vorderansicht Rückansicht

Anzahl

DGPS-AIR rechts	_____	☐
DGPS-AIR links	_____	☐

TSB

Silikonstreifen am Ärmelende.

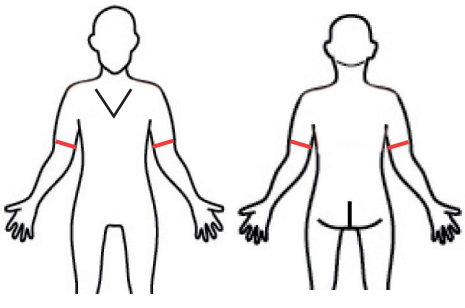

Vorderansicht Rückansicht

DGPS-TSB		☐

PRO WALK

individuelle Zusatzoptionen

LAX

Lycralage zur Verringerung der Lumballordose bei Hypermobilität und muskulärer Hypotonie.

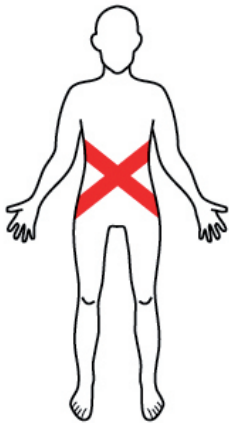

Vorderansicht

	Anzahl	
DGPS-LAX	_____	☐

TVS

Vertikale Abnäher, parallel zur Wirbelsäule, unterstützend für die Aufrichtung.

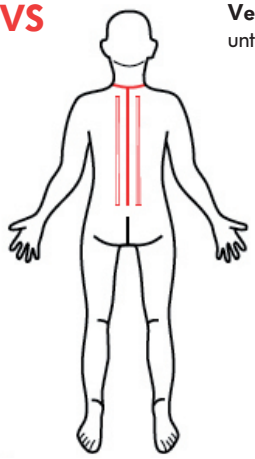

Rückansicht

DGPS-TVS	☐

TZP

Lycralage zur Verbesserung der Aufrichtung des gesamten Rückens, verbunden mit der Aufrichtung des Beckens und Schulterretraktion und -depression.

Vorderansicht Rückansicht

Vorsicht: Nicht bei kleinen Kindern und sehr schwachen Patienten anwenden!

	Anzahl	
DGPS-TZP	max 1	☐

TLR

(Abb. für rechts)

Lycralage zur Verbesserung der seitlichen Rumpfstabilität.

Vorderansicht Rückansicht

	Anzahl	
DGPS-TLR rechts	_____	☐
DGPS-TLR links	_____	☐

TPX

Lycralage zur Unterstützung der Lumballordose bei bestehender Lumbalkyphose.

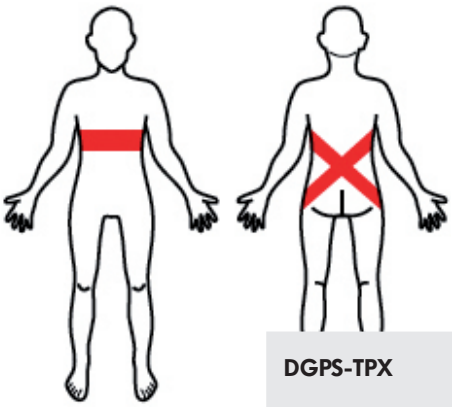

Vorderansicht Rückansicht

	Anzahl	
DGPS-TPX	_____	☐

PRO WALK

individuelle Zusatzoptionen

TCP
(**Abb. für rechts**)

Lycralage zur Minderung einer c-förmigen Skoliose (Anbringung an konvexer Seite, kann mit TTR kombiniert werden, keine Angabe des Scheitelpunktes nötig).

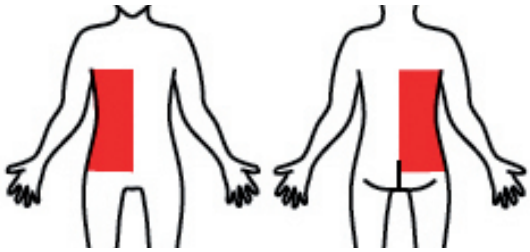

Vorderansicht Rückansicht

	Anzahl
DGPS-TCP rechts	☐
DGPS-TCP links	☐

TTR
(**Abb. für rechts**)

Lycralage zur Minderung einer c-förmigen Skoliose. Es ist die genaue Angabe des Scheitelpunkts vom Umfangmaß A ausgehend auf dem Maßblatt notwendig. (Kann mit TCP kombiniert werden)

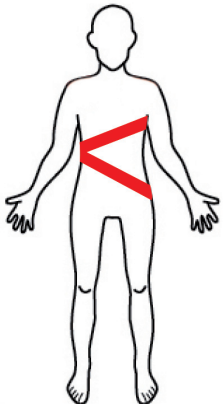

Vorderansicht



Rückansicht

Nur auf Modell DGPS-6 möglich!

	Anzahl
DGPS-TTR rechts	☐
DGPS-TTR links	☐

TDR
(**Abb. für links**)

Lycralage für die Derotation des Rumpfes im Uhrzeigersinn.

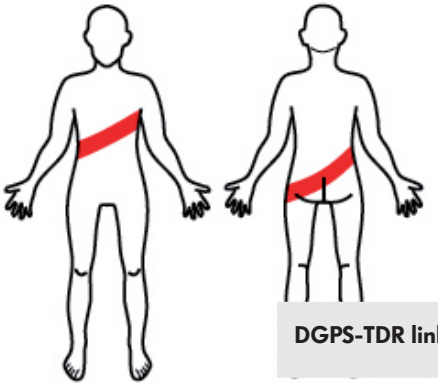

Vorderansicht Rückansicht

	Anzahl
DGPS-TDR links	☐

TDR
(**Abb. für rechts**)

Lycralage für die Derotation des Rumpfes gegen den Uhrzeigersinn.

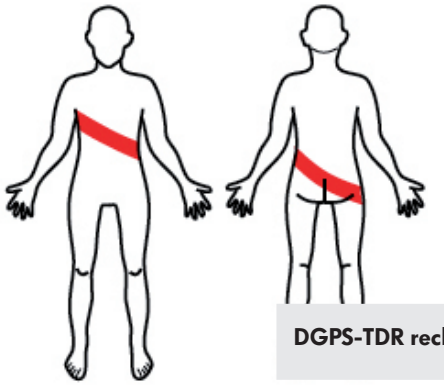

Vorderansicht Rückansicht

	Anzahl
DGPS-TDR rechts	☐

TGA

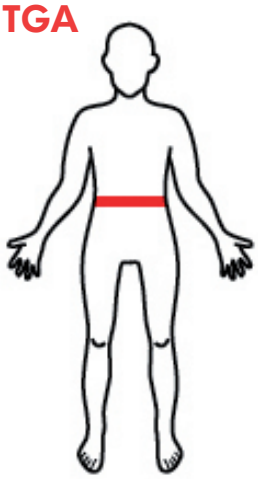

Vorderansicht

Wachstumsreserve (20 mm) – nur bei Orthesen in Standardausführung, ohne zusätzliche Auswahl an Lycralagen, die diesen Bereich kreuzen.

DGPS-TGA	☐

LHS

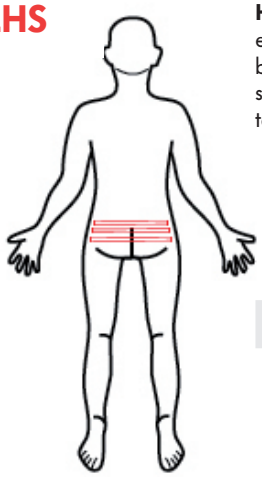

Rückansicht

Horizontale Abnäher (3 Reihen) – erhöhen die Kompression im Gesäßbereich und bieten zusätzlichen Widerstand gegen die Innenrotation und teilweise gegen die Adduktion der Beine.

DGPS-LHS	☐

PRO WALK

individuelle Zusatzoptionen

LPC

Lycralage zur Unterstützung der Aufrichtung des Beckens.

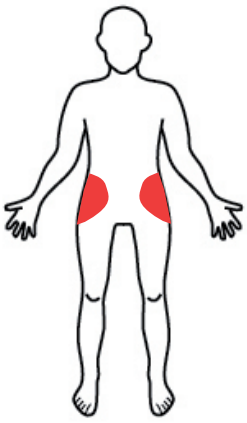
Vorderansicht

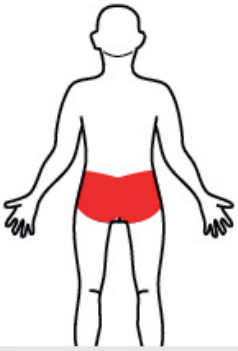
Rückansicht

Anzahl

DGPS-LPC _____ ☐

LPR

Lycralage zur Unterstützung der Derotation des Beckens (rechts bringt die rechte Beckenseite nach vorne, links bringt die linke Beckenseite nach vorne).

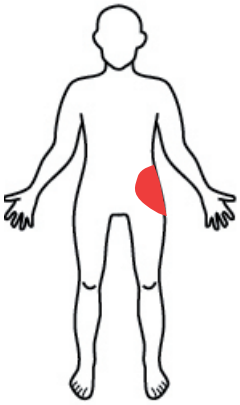
Vorderansicht


(**Abb. für rechts**)

Rückansicht

Anzahl

DGPS-LPR rechts _____ ☐

DGPS-LPR links _____ ☐

LPC(D)

Lycralage zur Unterstützung der Aufrichtung des Beckens in Kombination mit Unterstützung der Außenrotation der Beine.


Vorderansicht

Rückansicht

Anzahl

DGPS-LPC(D) _____ ☐

LPR(D)

(**Abb. für rechts**)

Lycralage für die Derotation des Beckens in Kombination mit Außenrotation des Beines.

Vorderansicht


Rückansicht

Anzahl

DGPS-LPR(D) rechts _____ ☐

DGPS-LPR(D) links _____ ☐

LSP

Lycralage übt zusätzlichen Druck auf die Gesäßmuskulatur aus – zur Förderung der neutralen Beckenstellung im Stehen.

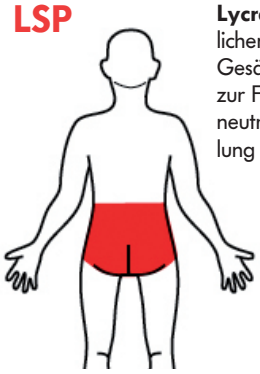
Rückansicht

Anzahl

DGPS-LSP _____ ☐

LAB

Beinansatz in Abduktion gefertigt – zur Verbesserung der Abduktion der Beine.

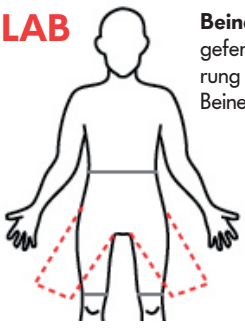
Vorderansicht

DGPS-LAB rechts ☐

☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°

DGPS-LAB links ☐

☐ 10° ☐ 20° ☐ 30°

LAP

Lycralage zur Verbesserung der Abduktion der Beine.


Vorderansicht


Rückansicht

Anzahl

DGPS-LAP rechts _____ ☐

DGPS-LAP links _____ ☐

LSE

Silikonstreifen an den Beinabschlüssen.


Vorderansicht


Rückansicht

DGPS-LSE ☐

Sonderoptionen

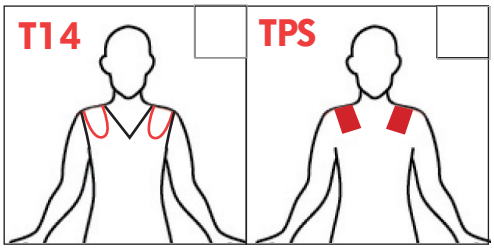

• nur für die Modelle DGPS-7.1 und DGPS-7.2

Velcro-Klettverschlüsse auf den Schultern, Klettstreifen verläuft über dem Scheitelpunkt der Schulter.	**DGPS-T14** ☐
Abgepolsterter Schulterträger	**DGPS-TPS** ☐

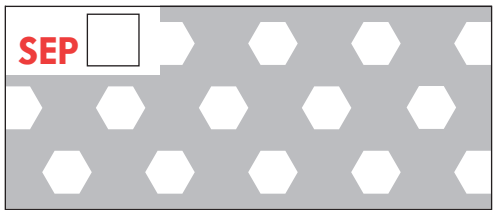

meshförmige Silikonbeschichtung von Lycralagen - zur Verstärkung der Wirkung **ja** ☐ **nein** ☐

gewünschte Lycralage(n):

Sonderoptionen gegen Aufpreis

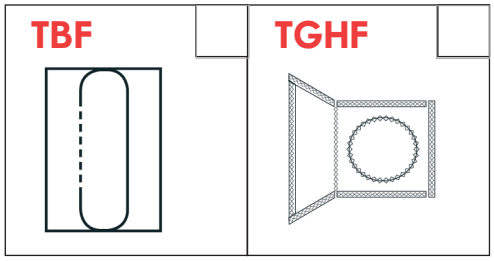

• Aussparungen für PEG-Sonden:

In Kombination mit **T11** schräg verlaufender Reißverschluss ventral (ersetzt den Standard-Reißverschluss)

DGPS-TBF	PEG-Abdeckung ähnlich einem Eingriff einer Boxershorts
DGPS-TGHF	Aussparung für PEG-Sonde, Abdeckung verschlossen durch Klett-/Flauschband

Wichtig: Festlegung der Position während der Zwischenanprobe!

• BH-Optionen: (bitte tragen Sie die erforderlichen Maße in das Maßblatt ein!)

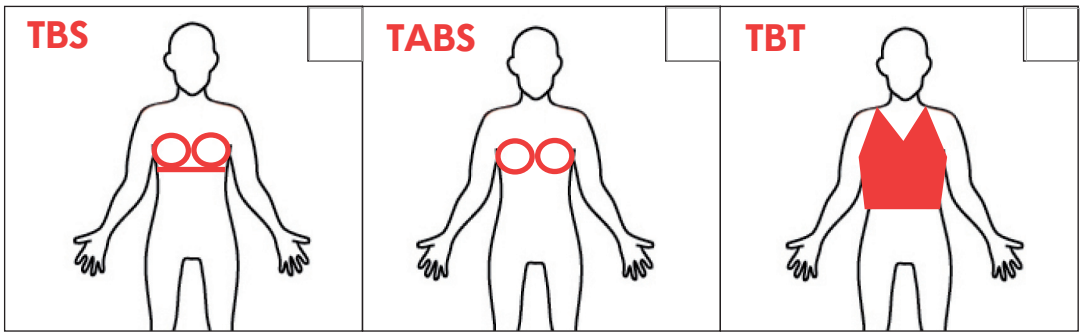

DGPS-TBS ☐	Lycrakörbchen nach Maß mit Unterstützung der Brust – bei großer BH-Größe empfohlen – bitte Maße auf dem Maßblatt eintragen
DGPS-TABS ☐	Lycrakörbchen nach Maß für kleine BH-Größen – bitte Maße auf dem Maßblatt eintragen
DGPS-TBT ☐	weicher Materialeinsatz für beginnende Brustentwicklung (**ohne Aufpreis**)

Verschlüsse

An den **Beininnenseiten** bei **offenem Schritt:**



T2F

Reißverschlüsse leicht nach ventral versetzt (erforderliche Mindestlänge Maße R/L20 10 cm)



T2

Reißverschlüsse (erforderliche Mindestlänge Maße R/L20 10 cm)



T7F

Druckknöpfe leicht nach ventral versetzt



T7

Druckknöpfe

T8F

Klett-verschlüsse leicht nach ventral versetzt

T8

Klettverschlüsse

An den **Beininnenseiten** bei **geschlossenem Schritt:**

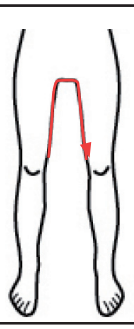

T3

Durchgehender Reißverschluss an der Innenseite der Beine

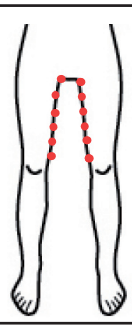

T6

Durchgehend Druckknöpfe an der Innenseite der Beine

Beinaussenseite:

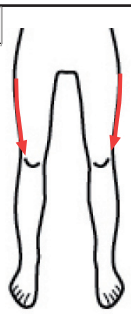

T1 empfohlen!

Hilfsreiß-verschluss an der Bein-aussenseite (zum besseren Handling immer empfohlen)

Am Torso:

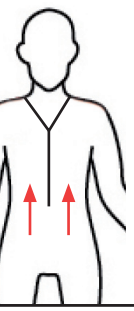

T9

2 Reißverschlüsse zur abdominalen Druckentlastung (z.B. bei Reflux und zur besseren Bauchatmung)

T11

Schräg verlaufender Front-reißverschluss – bei PEG- Öffnung erforderlich, ersetzt den vorderen Standardreiß-verschluss)

T20

Durchgehender Front- und Rückenreiß-verschluss - nur in Verbindung mit einem offenen Schritt möglich (ersetzen den vorderen und hinteren Stan-dardreißverschluss)

An den Armen:

T12

Reiß-verschlüsse an den Ärmel-enden

Zusätzlich:

T5

Elastische Klettverschlüsse an den Enden der Reißverschlüsse

T13

kleine Verlänge-rungsschlaufe an allen Reißver-schlussschiebern

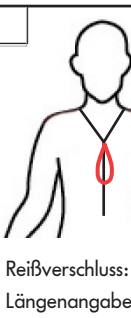

EZG

große Schlaufe an den Reißverschluss-schiebern

Reißverschluss: _____

Längenangabe: _____

• **Komfort:** **Leichte Unterpolsterung** an den Reißverschlüssen/gewünschter Verschluss:

Wählen Sie Ihre Farboptionen:

1 Baumwollträgermaterial

- Beige ☐
- Flieder ☐
- Dunkelblau ☐
- Schwarz ☐
- Weiß ☐
- Rot ☐
- Dunkelgrün ☐
- Dunkellila ☐
- Hellrosa ☐
- Hellblau ☐

Zusätzlich zur Grundfarbe:

- Sweetheart* ☐

- Iceage* ☐

*(wird ventral an der Orthese platziert)

2 Lycralagen

- Beige ☐
- Flieder ☐
- Dunkelblau ☐
- Schwarz ☐
- Weiß ☐
- Pink ☐
- Rot ☐
- Hellrosa ☐
- Hellblau ☐

3 Nahtfarben

- Beige ☐
- Hellgrün ☐
- Flieder ☐
- Orange ☐
- Dunkelblau ☐
- Gelb ☐
- Schwarz ☐
- Cerise ☐
- Weiß ☐
- Dunkelgrün ☐
- Pink ☐
- Dunkellila ☐
- Rot ☐
- Hellblau ☐
- Hell - rosa ☐

Bitte beachten Sie, dass die farblichen Abbildungen auf dem Papier etwas anders zur Geltung kommen.

Datum: Ansprechpartner:

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH

Bestellbogen per E-Mail senden